



주식회사 세종메디칼 건강한 미래를 여는 의료기기

SEJONG
M E D I C A L

2022.01 CI 규정집

세종메디칼 CI 규정집 지침

본 매뉴얼은 세종메디칼의 CI의 이미지 표준화 규정집이므로 체계적이고 일관성 있게 활용해야 한다.

무엇보다 중요한 것은 세종 메디칼의 이미지를 통일감 있게 창출하기 위해
본 매뉴얼의 예시된 항목별 규정에 따라 항상 엄격하고 철저하게 관리하여
정확히 사용해야 하며 심볼마크의 형태, 색상, 문자 등을 임의로 변형해서 사용하는 것을 절대 금한다.

매뉴얼에 수록된 내용은 외부에 유출하거나 복제하는 일이 없도록 해야 하며,
개인이 임의로 해석하거나 내용을 변경하여 사용할 수 없다.
또한 규정적용이 어려운 상황이 발생하거나 의문, 해석이 필요한 경우에는
반드시 관리부서인 기획실과 디자인팀 협의를 거쳐야 한다.

각 항목별 제작, 발주시에는 필요한 부분만 발췌하여 대여하도록 하며
제작완료와 동시에 회수하여 반복사용에 지장이 없도록 해야 한다.

특별히 작도가 필요한 경우에 한하여 제시된 그리드의 확대, 축소로 정확하게 사용해야 한다.

시간의 경과로 인한 재질 및 상황의 변화에 따라 필요한 경우에는 디자인에 대한
점진적 수정, 보완이 가능하며 이 경우에도 반드시 관리부서와 협의를 거쳐 결정해야 한다.

Basic System

- 3 Basic Logo / Typeface
- 4 Symbol Mark
- 5 Logo Mark
- 6 Logo Type
- 7 Grid System
- 8 Signature - 국문
- 9 Signature - 영문
- 10 Corporator Color
- 11 Symbol Color Regulation
- 12 Incorrect Usage

Basic Logo

기본 로고

본 매뉴얼은 CI의 Basic System으로 구성되어 있으며, 세종메디칼을 대내외에 알리고 보다 적극적으로 홍보하기 위해 이미지 체계를 일관성 있게 갖추어 놓은 규정이다.



Typeface

지정서체

세종메디칼의 지정 서체는 CI의 각종 인쇄, 홍보물, 사인 등에 사용되는 서체를 지정한 것으로 세종메디칼의 시각적 이미지를 더욱 일관되고 통일성 있게 하려고 선택한 지정서체이다.

Noto Sans
Thin / 100

가나다라마바사아자차카타파하
아야어여오요우유으이애애에예
1234567890!@#%^&*()-=+[:]"<?

Noto Sans
Medium / 500

가나다라마바사아자차카타파하
아야어여오요우유으이애애에예
1234567890!@#%^&*()-=+[:]"<?

Noto Sans
Light / 300

가나다라마바사아자차카타파하
아야어여오요우유으이애애에예
1234567890!@#%^&*()-=+[:]"<?

Noto Sans
Bold / 700

가나다라마바사아자차카타파하
아야어여오요우유으이애애에예
1234567890!@#%^&*()-=+[:]"<?

Noto Sans
Regular / 400

가나다라마바사아자차카타파하
아야어여오요우유으이애애에예
1234567890!@#%^&*()-=+[:]"<?

Symbol Mark

심벌마크

심벌마크는 세종메디칼의 브랜드 자산으로서 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 요소이며, 규정과 원칙을 반드시 준수하여 왜곡, 변형 및 오남용해서는 안 된다.



심벌의 컨셉과 의미

“미래를 향해 진취적으로 뻗어가는 세종메디칼”

세종메디칼의 심벌은 상승의 이미지를 통해 세계를 향해 유연하고 진취적으로 뻗어나가고자 하는 세종메디칼의 추구 가치를 반영하였다. 사람 개개인의 건강, 행복을 첨단 의료기기로 서포트하여 건강한 미래를 약속하는 세종메디칼의 이미지를 상징하며, 전체적으로 안정감을 느낄 수 있는 구조와 비례로 안정된 기술력과 전문성을 느끼도록 표현하였다. 신뢰, 건강, 행복을 표현하는 Blue 3색을 메인 컬러로 사용한다.

Logo Mark

로고마크

로고마크는 심벌마크와 더불어 세종메디칼의 이미지를 전달하는 중요한 기본 요소로 심벌마크가 주는 이미지와 조화될 수 있도록 디자인되었으며 각각의 글자꼴 형태에 따라 비례 조정한 것이므로 글자의 꼴, 굵기, 비례 등을 임의로 변경해서는 안 된다.

영문상하조합


SEJONG
M E D I C A L

최소 공간 규정

비례규정



공간규정

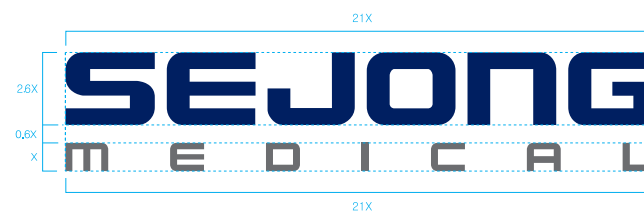

LogoType

로고 타입

로고 타입은 심벌과 더불어 세종메디칼의 이미지를 전달하는 중요한 기본요소로 심벌이 주는 이미지와 조화될 수 있도록 디자인 되었으며 각각의 글자꼴 형태에 따라 비례 조정한 것이므로 글자의 꼴, 굵기, 비례 등을 임의로 변경하여서는 안 된다.

국문 사명

세종메디칼

국문 약칭 사명

(주) 세종메디칼

국문 정식 사명

주식회사 세종메디칼

영문 사명

Sejong Medical

영문 정식 사명


Sejong Medical CO., LTD

Grid System

그리드 시스템

메인 심벌은 세종메디칼을 대표하는 가장 중요한 요소이므로 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 작도하여 심벌마크의 이미지를 손상하별 경우가 없어야 한다.
그러므로 심벌마크를 사용 또는 작도해야 하는 경우에는 아래 그리드 시스템을 이용하여 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

심벌마크

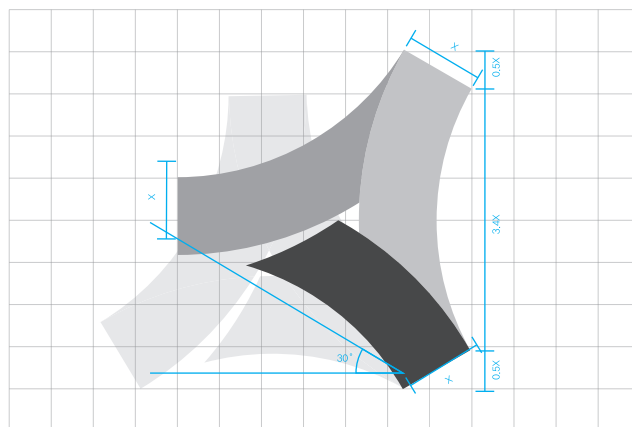


최소 사이즈 규정



상하조합의 워터마크는 보기와 같이
규정한 20mm 미만일 경우에는 사용
할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

기본형

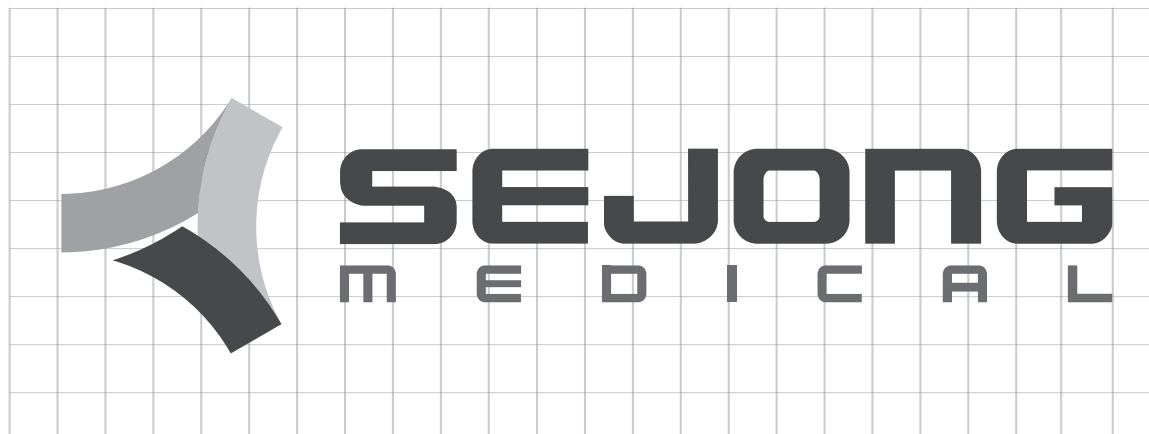

Signature

시그니처-국문

심벌과 로고타입 또는 슬로건을 조직적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 통합된 기업 이미지를 보여주기 위한 것이며, 시그니처 활용은 상황에 따라 적절하게 선택하여 활용할 수 있다.

심벌&국문 정식사명
&슬로건 상하조합



심벌&국문 로고타입
좌우조합



Signature

시그니처-영문

심벌과 로고 타입 또는 슬로건을 조직적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 통합된 기업 이미지를 보여주기 위한 것이며, 시그니처 활용은 상황에 따라 적절하게 선택하여 활용할 수 있다.

영문 로고 타입 좌우조합



심벌&영문 로고 타입
상하조합



심벌&영문 로고 타입
좌우조합




Corporate Color

전용 색상


세종메디칼의 CI의 전용 색상은 세종메디칼을 차별화 시키는 또 하나의 중요한 수단으로 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로 사용하는 것이 중요하다.

전용 색상의 표현은 CMYK 4도 프로세스 컬러 사용을 원칙으로 하나 적용되는 매체에 따라서 별색을 사용할 수 있다. 적용 시 반드시 본 규정집에 제시된 색상 규정 지침을 따르도록 한다.


주색상



- RGB Color / R 22 G 32 B 76
- CMYK Color / C 100 M 100 Y 20 K 25




- RGB Color / R 85 G 126 B 192
- CMYK Color / C 70 M 45 Y 0 K 0




- RGB Color / R 134 G 179 B 224
- CMYK Color / C 20 M 20 Y 0 K 30


보조색상




- RGB Color / R 201 G 199 B 197
- CMYK Color / C 25 M 20 Y 20 K 0



- RGB Color / R 0 G 40 B 122
- CMYK Color / C 100 M 70 Y 0 K 30



- RGB Color / R 26 G 100 B 102
- CMYK Color / C 70 M 60 Y 50 K 5



- RGB Color / R 0 G 40 B 122
- CMYK Color / C 100 M 70 Y 0 K 30

Symbol Color regulation

심벌 색상 규정

세종메디칼의 심벌마크의 기본 색상 표현에 가장 이상적인 배경 색상은 흰색이다. 매체의 특수한 상황에 따라 배경 색상의 활용이 제한될 경우 아래에 제시 배경색에 따른 색상 활용 규정에 준하여 적용해야 한다. 색상을 잘못 활용하면 명도, 채도에 따라 가독성을 잃거나 이미지에 혼란을 초래하므로 항상 효과적으로 사용할 수 있도록 한다.

배경색에 따른 컬러 적용



NAVY



BLUE



SKY BLUE



GRAY



WHITE

명도에 따른 심벌 활용



WHITE

25

50

75

100

Incorrect Usage

금지 규정

심벌마크와 로고타입은 세종메디칼을 상징하는 중요한 요소이므로 색상과 형태를 임의로 바꾸거나 변형해서 사용하는 것을 금한다.
제시된 예는 잘못 사용될 수 있는 대표적인 예이다.



1. 규정에 벗어난 칼라를 적용한 경우

2. 기울기를 임의로 변경한 경우

3. 로고타입의 굵기를 임의로 변경한 경우

4. 로고타입의 간격을 임의로 변경한 경우

5. 로고타입의 크기를 임의로 변경한 경우

6. 로고타입의 테두리를 적용한 경우

7. 로고타입을 라인으로 처리한 경우

8. 심벌마크와 로고타입을 라인으로 처리한 경우

9. 로고타입과 유사한 배경색을 사용한 경우

10. 배경칼라가 복잡한 경우

